HZIJJ-III

赫兹电力 HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

五

五

五

五

五

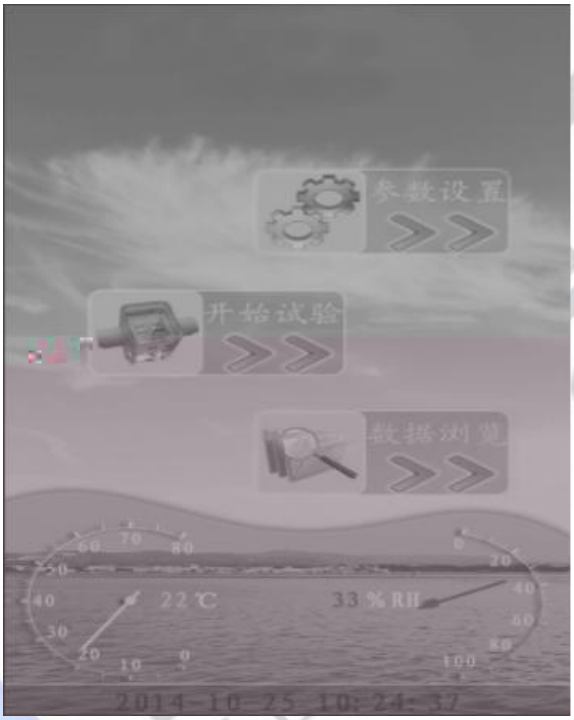
参数设置
开始试验
数据浏览
22℃
33 %RH
2014-10-25 10:24:37

参数设置
开始试验
数据浏览
22 ℃
33 %RH
2014-10-25 10:24:37

参数设置
升压设置
停升电压: 80 kV
搅拌时间: 10秒
静放时间: 15 分
升压间隔: 5 分
升压次数: 6
升压速度: 3.5 kV/s
打印设置
是
时间设置
2014-10-25 10:24:37
杯位选择
杯位1: 是
杯位2: 是
杯位3: 是

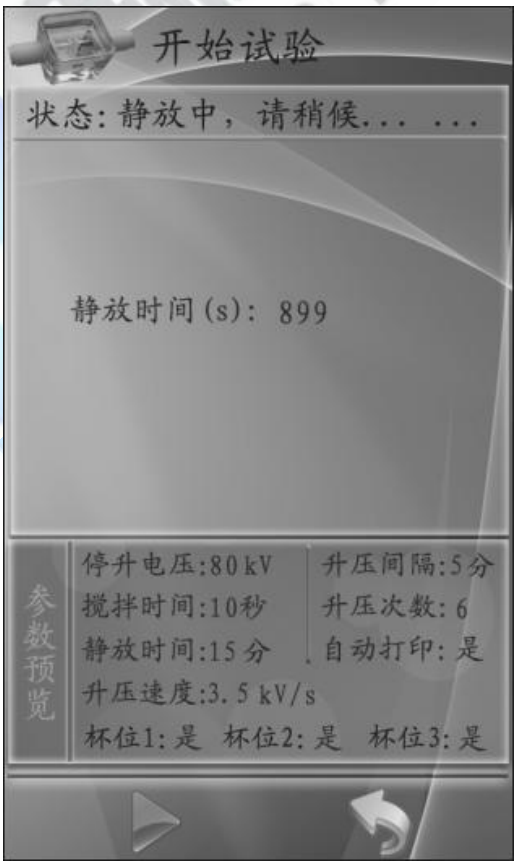
开始试验
状态：静放中，请稍候... ...
静放时间(s)： 899
参数预览
停升电压:80 kV
升压间隔:5分
搅拌时间:10秒
升压次数: 6
静放时间:15 分
自动打印: 是
升压速度:3.5 kV/s
杯位1: 是 杯位2: 是 杯位3: 是

五

数据浏览打印
页码值: 15/99 1号杯
平均值: 71.39kV
[1]74.82kV [2]63.50kV
[3]68.84kV [4]78.23kV
[5]77.40kV [6]65.56kV
标准偏差: 5.73kV
变异系数: 0.080
温度: 33℃
湿度: 35%RH
时间: 2014/07/22 16:38:44

五

五

五

- ○
- ○
- ○
- ○
- ○
- ○

赫兹电力
HERTZ POWER

五

五

五